

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle ustanovení § 98 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zadávací dokumentace“ a „Zákon“), k veřejné zakázce

Zdravotnické přístroje a vybavení

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel

Název: Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7

Sídlo: Strossmayerovo náměstí 1477/6, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 44797362

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: PhDr. Josef Dušek, ředitel

tel.: +420 777 772 483

e-mail: reditel@saz7.cz

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Marek Šrámek, smluvní zástupce zadavatele

tel.: +420 606 475 052

e-mail: mareksramek@centrum.cz

obdržel dne 4. 12. 2017 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Níže zadavatel uvádí text žádostí s připojeným textem poskytnutého vysvětlení:

Žádost č. 1:

V příloze č. 1 ZD, technická specifikace: Echokardiograf, uvádíte požadavek „Kompatibilita se stávajícím serverovým systémem polikliniky pro ukládání obrazových i patientských dat“. Předpokládáme, že tento požadavek souvisí s požadavkem „Plná kompatibilita DICOM s možností importu Worklistu a exportu na DICOM server“.

Dotaz: *Může zadavatel potvrdit, že požadavek „Kompatibilita se stávajícím serverovým systémem polikliniky pro ukládání obrazových i patientských dat“ znamená požadavek nabídnout přístroj s DICOM rozhraním tak, aby bylo možno ukládat patientská a obrazová data na PACS zadavatele?*

Vysvětlení č. 1: Ano, zadavatel potvrzuje, že požadavek „Kompatibilita se stávajícím serverovým systémem polikliniky pro ukládání obrazových i patientských dat“ znamená požadavek nabídnout přístroj s DICOM rozhraním tak, aby bylo možno ukládat patientská a obrazová data na PACS zadavatele.

Žádost č. 2:

V příloze č. 1 ZD, technická specifikace: Echokardiograf, uvádíte požadavek „2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace ve dvou rovinách - matrix. kmitočtový rozsah cca 1,5-4 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI) pro kardiologické aplikace“ a „matrixová širokopásmová sektorová sonda pro diagnostiku v oblasti srdce, frekvenční rozsah 1-5 MHz, 3.040 elementů minim, 2D/3D/4D, PW, CW, barevný doppler, tkáňový doppler, harmonické zobrazování, harmonické zobrazování LVO, M-mode, barevný M-mód, Live xPlane zobrazení, low/hi MI“.

Druhá z požadovaných sektorových sond z cela nahrazuje použití sektorové sondy první.
Dotaz: Trvá zadavatel na dodání 2D sektorové sondy, když k přístroji zároveň požaduje 2D/3D/4D sektorovou sondu?

Vysvětlení č. 2: Ano, zadavatel trvá na dodání obou sond.


Žádost č. 3: (část 3 „Operační stůl“ veřejné zakázky s názvem „Zdravotnické přístroje a vybavení“) Požaduje zadavatel dle běžných standardů odnímatelnou pracovní desku?

Vysvětlení č. 3:

Zadavatel trvá na původním požadavku na zákrokový stůl mobilní s pevnou operační deskou.

V Praze dne 5.12.2014

Sdružené ambulantní zařízení v Praze
Strossmayerovo nám. 6 Praha 7
statutární zástupce
IČ: 44797362 tel.: 270 005 539

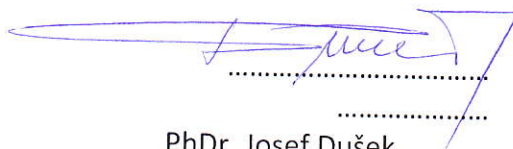

PhDr. Josef Dušek
ředitel